バルブ実流実験装置備品使用に関するお願い

・備品は、次に使用される方のために、**必ず**使用前の状態に戻してください。
・片付け時は、下記表に基づいて自主チェックを行って下さい。
・片付けが終わりましたら、**職員の立ち合い確認**を受けてください。
・不明点が有りましたら、職員までご連絡下さい。

名称	使用後の状態および確認事項
落水器	□ 使い終わったらドレン弁は開にしておいてください。
圧力センサ 差圧計	□ センサは丁寧に取り扱ってください(本体、ケーブルに破損のないよう) □ 使い終わったら元の位置に戻してください。 □ 圧力計配管内の水は抜いてから戻してください(透明チューブ内の水は残しておいてください)。 □ センサー接続用のニップルは元の位置に戻してください □ コード、チューブは絡まらないよう扱ってください。 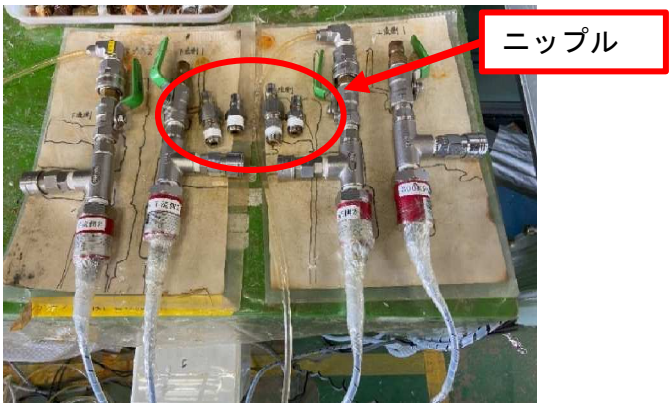
上流弁	□ 使用後は100A、200A共に全閉にしてください。 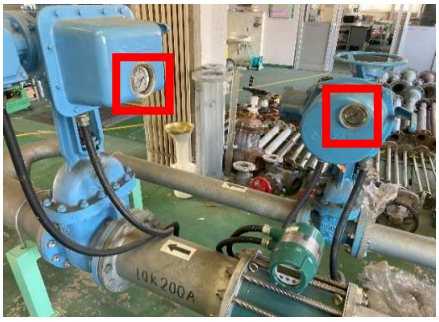

上流側ドレン弁	□ 使用後は開けておいてください。
空気抜き弁	□ 使用後は根元のバルブを閉めてください。
逃がし弁	□ 使用後は全閉にしてください。
ポンプ周り	□ 水漏れ等発生の際はご連ください。
クレーン	□ ケーブルが乱巻きのまま放置しないでください。 □ クレーン使用後はブレーカーOFF(職員がOFFにします)。 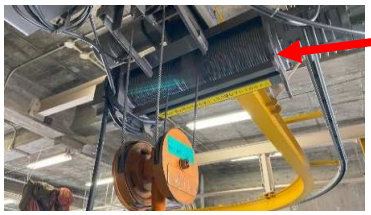
操作盤 ブレーカー	□ 使用後はすべて電源OFFにしてください。 □ ポンプ停止の際は電源周波数30Hzで停止してください。
PC	□ 使用後はシャットダウンしてください。 □ 忘れ物、USBの抜き忘れの無きようご注意ください。
エアコン	□ 使用後は消し忘れにご注意ください。

スポットクーラー	□ 使用後は元の位置に戻してください。 □ 使用後は電源をOFFにしてください。
ストーブ エアコン	□ 使用の際は職員にお申し付けください（職員がON/OFFします）。
コードリール （借りた場合）	□ 使用後は巻き取ったうえで返却してください。
治具・工具	□ 使用後は元の位置に戻してください。 当センターの工具を誤って持ち帰られ無いようお願いいたします。
ボルト、ナット ワッシャ	□ ボルト、ナット、ワッシャはセットにして元の位置に戻してください。
管受け台	□ 使用後は元の位置に戻してください。
パッキン	□ サイズ毎に分けて元の位置に戻して下さい（7.5Kと10Kを混ぜないこと）。
配管	□ **表示（配管番号、サイズ表記）が上**になるようにして元の位置に戻して下さい。 □ レジューサー管は凸部が上になるように戻して下さい（重心が下になるように）。 □ 配管は転がらないように木材等で転がり止めしてください。 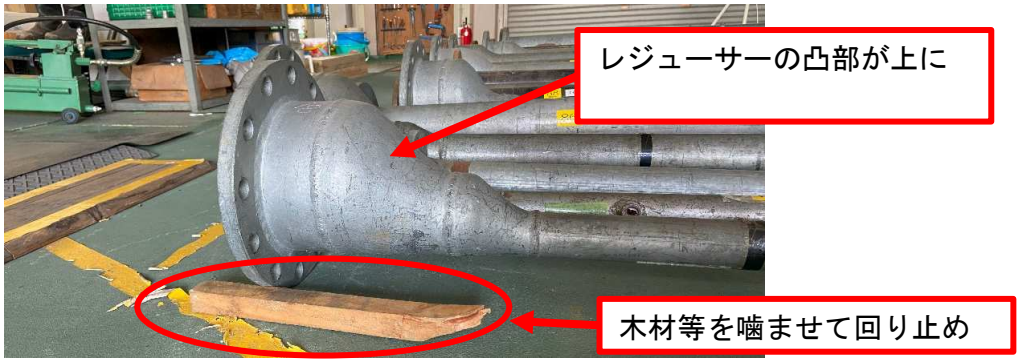
窓	□ 窓を開けた場合は全て閉めてください。

Ver.20230517　是枝